



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
HORIZONTE - CE

PROPOSTA COMERCIAL REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018.10.17.1-PE

ABERTURA: 14/11/2018

HORÁRIO: 10:00HS

Razão Social: Cirúrgica São Felipe Produtos para Saúde EIRELI

CNPJ: 07.626.776/0001-60

Sócia: Sra. Maristela Belotto Pelozzo

CPF: 922.630.709-15

RG: 5.916.363-9/SESP/PR

Endereço: Rod. dos Minérios, nº 403, Sala 08, Jardim Monterrey, Almirante Tamandaré/PR, CEP 83.507-000.

Dados Bancários:

Banco do Brasil

Caixa Econômica Federal

Banco Bradesco

Banco Itaú

AG: nº 1622-5

AG: nº 1630 - OP 003

AG: 01205-0

AG: 3701

C/C: 27.649-9

C/C: 2284-8

C/C: 0004333-8

C/C: 33000-7

Tel/ Fax: (41) 3354-1001

e-mail: cirurgicasaofelipe@uol.com.br

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta comercial para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme exigido no Edital de Pregão Eletrônico, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	Marca/ Fabricante/ Modelo/ Registro no M.S. nº	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
02	2	UND	ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL: Característica Física Especificação: Material de confecção em aço / ferro pintado, Aplicação adulto, braçadeira/ fecho em nylon/ velcro, tipo aneróide.	PREMIUM/WENZHOU KANGJU MED. INST. CO. LTD-CHINA, REPÚBLICA POPULAR/ H200 RODIZIO/ 80275310022	344,99	689,98
	1	UND	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL: Característica Física Especificação: Capacidade de 6 a 10 litros, Suporte com rodízios, Válvula de segurança em frasco termoplástico/vidro.	OLIDEF/ OLIDEF CZ IND COM AP HOSP LTDA-BRASIL/ A 45 - PLUS/ 10227189012	2.549,99	2.549,99
13	6	UND	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO: Característica Física Especificação: Material de confecção em aço inoxidável, apoio de braço em aço inoxidável, tipo pedestal altura regulável.	FM/ FORÇAMÉDICA IND. E COM. DE MÓV. HOSP. LTDA-EPP-BRASIL/ FM-0010/ 81130999001	208,99	1.253,94
19	6	UND	ESTETOSCÓPIO ADULTO: Característica Física Especificação: tipo duplo, auscultador aço inoxidável.	PREMIUM/ NINGBO SIFANG MED. INST. CO., LTD.-CHINA, REPÚBLICA POPULAR/ DUPLO ADULTO/ 80275310052	21,99	131,94
20	4	UND	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO: Característica Física Especificação: Material de confecção em tecido em nylon, braçadeira/ fecho velcro.	PREMIUM/ WENZHOU KANGJU MED. INST. CO. LTD-CHINA, REPÚBLICA POPULAR/ BR-20D/ 80275310022	58,00	232,00





24	1	UND	LANTERNA CLINICA: Característica Física Especificação: Tipo Led.	MIKATOS/ MIKATOS IND., COM. E SERV. DE AP. MED. LTDA- EPP-BRASIL/ 022/PPR/ 80218939001	68,00 ✓	68,00 ✓
27	3	UND	OXÍMETRO DE PULSO: Característica Física Especificação: Tipo Portátil de mão, sensor de SpO2 01.	ALFAMED/ ALFA MED SIST. MED. LTDA- BRASIL/ SENSE 10/ 80629370004	1.800,00 ✓	5.400,00 ✓
30	4	UND	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU): Característica Física Especificação: Aplicação Infantil, possui reservatório, material de confecção em silicone.	FARMATEX/ LAKHANI MEDICARE PVT.LTD- ÍNDIA/ PEDIÁTRICO/ 80440960008	150,00 ✓	600,00 ✓
VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: dez mil, novecentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos					TOTAL	10.925,85

Declaramos:

Que concordamos com todas as condições do edital, que todos os produtos cotados possuem garantia de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, que estão inclusos no valor acima propostos todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.


Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de Tributação de Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece Artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da sessão pública.

Entrega: Conforme Edital

Pagamento: Conforme Edital

Almirante Tamandaré, 14 de novembro de 2018.


Michael W. G. Neves
Representante Legal
RG 8.881.858-0
CPF 040.865.529-14



Esfigmomanômetro Hospitalar com rodízios Premium



Conteúdo:

- 01 Manual de Instruções
- 01 Manômetro
- 01 Tubo helicoidal
- 01 Conjunto pêra e válvula de deflação
- 01 Pedestal com alça e rodízios
- 01 Braçadeiras, disponível no seguinte tamanho:
 - Adulto de nylon com fecho de velcro → *10cm O2*



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Faixa de medição: 0-300 mmHg.
- Divisão de escala: 2 mmHg.
- Acuracidade técnica: ± 3 mmHg em temperaturas de 0°C-35°C e umidade relativa do ar de 85%.
- Escape máximo de ar com válvula fechada: 4 mmHg.
- Exaustão rápida: de 200 mmHg para 15 mmHg em menos de 10 segundos.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



(Imagem Ilustrativa)

Aspirador A 45Plus

Item 08

[Handwritten mark]

- Aspirador compressor para utilização médica, odontológica e laboratorial, com mecanismo totalmente isento de óleo e baixo nível de ruído.
- Ajustes independentes para ar comprimido e vácuo.
- Vacuômetro graduado até 30 pol. Hg.
- Potência do motor (CV) 1/4.
- Funcionamento por meio de sistema de diafragma.
- Alça para transporte.
- Tampa do frasco removível, com válvula de segurança anti-transbordamento.
- Motor de alta durabilidade ideal para utilização em hospitais, clínicas e consultórios.
- 02 Frascos coletores de de policarbonato (inquebrável), de 5 litros, transparentes e autoclaváveis.
- Pedal para acionamento contínuo/intermitente.
- Microfiltro bacteriológico.
- Acompanha suporte com rodízios.
- Manual de operação.

[Handwritten signature]

FM-0010

Item 13



Imagem ilustrativa

BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO

- Base em tripé de ferro
 - haste em tubo de aço cromado
 - Concha cromada
 - Altura regulável por meio de manípulo
 - Pés com ponteiros plásticos
 - Acabamento em pintura epóxi, com tratamento anti-ferruginoso
- Registro MS: 801130999001

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



Premium



Item 19

Estetoscópio Duplo Premium



(Handwritten mark)

DESCRIÇÃO

- Baixo peso
- Diafragmas de alta sensibilidade
- Disponível em 3 versões adulto pediátrico e neonata *Item 19*
- Tubo moldado em PVC de peça única para melhor transmissão do som
- 1 ano de Garantia

FICHA TÉCNICA

Disponível em 3 versões: adulto, pediátrico e neonata

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Esfigmomanômetro Aneróide Premium



Conteúdo:

01 Manual de Instruções

01 Manômetro

01 Conjunto pêra e válvula de deflação

01 Bolsa

01 Braçadeira com manguito acoplado disponível no seguinte tamanho:

- Braçadeira Tamanho adulto de nylon com fecho de velcro; *→ 78cm 20*

Visão Geral



Modelo BR-20D

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Faixa de medição: 0-300 mmHg.
- Divisão de escala: 2 mmHg.
- Acuracidade técnica: ± 3 mmHg em temperaturas de 0°C-35°C e umidade relativa do ar de 85%.
- Escape máximo de ar com válvula fechada: 4 mmHg.
- Exaustão rápida: de 200 mmHg para 15 mmHg em menos de 10 segundos.
- <http://www.glicomed.com.br/?product=esfigmomanometro-aneloide-com-bracadeira-colorida>

[Handwritten signature]



Lanterna Missouri LED


Ref. 022 - PPR



Cabo (punho) em Alumínio Anodizado para 02 (duas) pilhas pequenas tamanho AAA (tipo palito) (*)

Manual de Instruções Lanterna Missouri LED

Ref. 022 - PPR

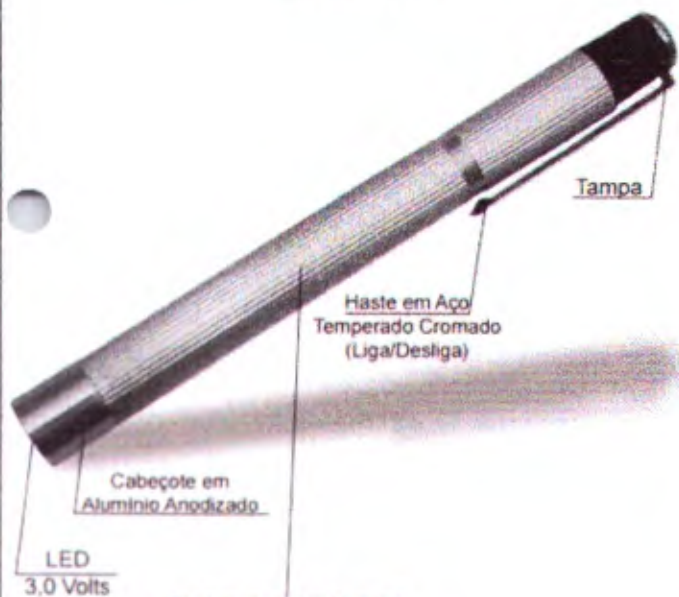

Cabo (punho) em Alumínio Anodizado para 02 (duas) pilhas pequenas tamanho AAA (tipo palito) (*)

(*) Pilhas vendidas separadamente.



Lanterna Missouri LED

1 - Finalidade:

A **Lanterna Missouri LED** é um aparelho portátil utilizado para auxiliar a iluminação nos exames clínicos de rotina em Hospitais, Clínicas e Consultórios Médicos em geral.

2 - Instruções de Uso/ Funcionamento:

- Retirar a tampa da extremidade do cabo girando no sentido anti horário.
- Colocar dentro do cabo 02 (duas) pilhas pequenas do tamanho AAA (tipo palito) e rosquear no sentido horário a tampa na extremidade para fechar a lanterna.
- Em seguida, para ligar o LED da lanterna segurar o cabo e empurrar com leve pressão a haste contra o mesmo.
- Para desligar, fazer operação contrária soltando a haste do cabo.

Importante:

Usar pilhas alcalinas de boa qualidade e nunca deixá-las dentro do aparelho quando não estiver em uso.

3 - Informações Adicionais / Limpeza / Armazenagem:

- Evitar movimentos bruscos ou batidas no aparelho.
- Nunca permitir que pessoas não habilitadas tentem consertar seu aparelho. Procurar sempre uma Assistência Técnica Autorizada.
- Conservar o seu aparelho sempre limpo utilizando um tecido macio sem fiapos umedecido com água e depois secar.
- A **Lanterna Missouri LED** deve ser guardada em local seco e fresco longe de crianças ou animais, de preferência na bolsa ou embalagem que acondiciona o produto.

Fabricado por:

Mikatos Indústria, Comércio e Serviços de Aparelhos Médicos Ltda.

CNPJ: 05.030.501/0001-34 - Indústria Brasileira

Estrada de São Judas, 325 - Parque Esplanada - Embu das Artes/ SP

CEP: 06817-170 - Fone: (11) 4781-8001/SAC

Resp. Técnico: Eng. Antonio Carlos Simões

CONFEA/SP: 060113888-1

Produto Registrado na ANVISA/MS sob nº:

80218939001



ALFAMED
SISTEMAS MÉDICOS

Cuidados para a vida

Produto Registrado:



Empresa certificada:



Flm 27

SENSE 10


Oxímetro de Pulso

www.alfamed.com

Tecnologia para melhor performance



Desenvolvido com tecnologia de ponta e parâmetros otimizados, o Sense 10 é um oxímetro de pulso portátil capaz de realizar uma medição sensível e confiável dos níveis de oxigenação no sangue mesmo sob difíceis condições de uso.

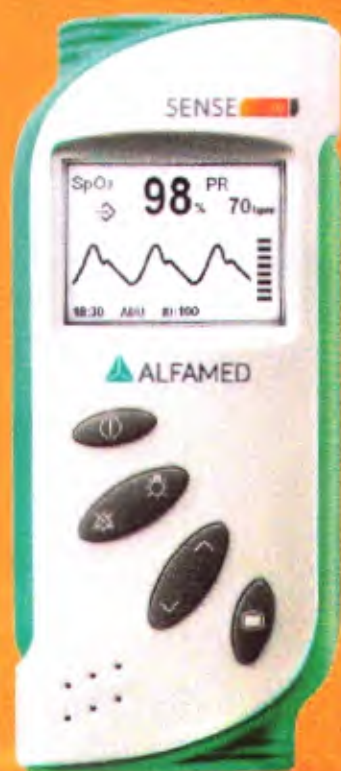

Sensor de dedo de alta precisão

Design para melhor obtenção de sinal.

Base móvel

Carregue em qualquer lugar em menos tempo e com maior proteção.



Suporte para beira de leito

Adaptável a qualquer situação de uso.

Usabilidade

O Design amigável facilita o manuseio do equipamento.



Alta proteção

O Sense 10 possui capas siliconadas que possuem alta resistência a quedas e outras situações cotidianas. (Grau de Proteção IPX2)



Gestão de Dados

A compatibilidade com o software *Patient Care* permite a gestão dos dados obtidos do paciente e visualização pelo PC.

Características Gerais:

- ◆ Medição de SpO₂
- ◆ Frequência de pulso
- ◆ Tela com onda pletismográfica
- ◆ Compatível com software de gestão de dados
- ◆ Indicador de Perfusão
- ◆ Faixa de Medição de SpO₂: 0 a 100%
- ◆ Faixa de Medição de freq. Pulso: 25 a 300 bpm
- ◆ Tela LCD
- ◆ Alarme audiovisual
- ◆ Tabelas de tendência
- ◆ Grande capacidade de armazenamento.
- ◆ Peso: 165 gramas
- ◆ Autonomia: Pilhas (48 horas) Bateria (36 horas)
- ◆ Tecnologia para baixa perfusão e movimentação

RESSUSCITADOR MANUAL INFANTIL

Item 30



CONHEÇA A PHARMATEX,
PRODUTOS INTERNACIONALMENTE
RECONHECIDOS
WWW.PHARMATEX.COM.BR



PADRÃO DE QUALIDADE RECONHECIDO INTERNACIONALMENTE

Utilizado para reanimação pulmonar de crianças e neonatos, para uso em crianças com peso corporal inferior a 20 kg, produto de fácil manuseio, confortável totalmente autoclavável; garantindo sua reutilização. O dispositivo permite a realização da ventilação por um socorrista único, possibilitando simultaneamente, a abrir as vias aéreas pela elevação da mandíbula, a pressionar a máscara fortemente contra o rosto do paciente e a realizar a compressão controlada da bolsa do ressuscitador. O conector permite o giro da máscara em 360° nos dois sentidos. Bolsa com 1000 ml e reservatório de oxigênio com volume de 600 ml de oxigênio, de forma a permitir o fornecimento de altas concentrações de oxigênio ao paciente. O sistema permite a entrega de no mínimo 85% de FIO2 se ligado a um fluxo mínimo de oxigênio de 3 a 5 litros por minuto. O sistema de reservatório assegura a otimização do oxigênio utilizado. Contém válvula de paciente que impede o retorno do fluxo do ar exalado pelo paciente para o balão do ressuscitador. Oferece feedback visual e tátil da condição pulmonar do paciente; tornando o processo de ressuscitação manual mais seguro. Limitação de pressão integrada para evitar a compressão com força excessiva, nos casos de resistência das vias aéreas do paciente. Possui ainda válvula limitadora de pressão em 40 cmH²O. Sistema de válvula com obturador único que melhora a visibilidade e o manuseio do fluxo de ar ao paciente. Todos os componentes são autoclaváveis, inclusive o reservatório de oxigênio tipo bolsa. A velocidade de expansão da bolsa é suficiente para todas as frequências recomendadas para uso prático. Volume máximo de ventilação: 300ml; Conector do paciente: 22/15mm (universal-ISO) Conector expiratório (para a válvula PEEP acoplada): 30mm MACHO (ISO) Espaço morto: menor que 6ml; Resistência inspiratória: (com ou sem o tubo de depósito de oxigênio) de 50L/min aproximada, -3,8cmH²O e a 5L/min aproximada -0,8 cmH²O. Resistência expiratória de 50L/min aproximado: 4,5 cmH²O e a 5L/min aproximada 0,6 cmH²O. Máxima pressão de descarga alcançável quando a válvula limitadora de pressão é anulada: de aproximadamente 118 cmH²O, abertura do limitador de pressão da válvula com máximo de 45 cm H²O. Caso haja excesso de pressão, a elasticidade da tampa externa deve limitar a pressão de ar ao máximo de 4,8kPa (48 cmH²O); Volume da bolsa 1000 ml e reservatório de oxigênio: 600ml (Reservatório de oxigênio tipo bolsa com volume mínimo de: 100ml Resistência inspiratória da bolsa do reservatório de oxigênio: a 50L/min aproximado: -1,0cmH²O) a 5L/min aproximado: -0,1cmH²O) Temperatura de funcionamento: -16°C a 50°C Temperatura de armazenamento: -30°C a 60°C A máscara é feita em polisulfona transparente, para permitir a detecção de regurgitação, cianose e respiração espontânea e bojo de silicone totalmente isenta de látex. A máscara pode ser ajustada através da insuflação de oxigênio, em válvula específica, ou seja, o bojo deve ser inflável. A máscara pode ser reutilizável e esterilizada por autoclave. Acompanha máscara facial transparente de silicone, tamanho 2.



farmatex

A Farmatex, importa e distribui produtos médicos e hospitalares em todo território brasileiro, prezando sempre por um altíssimo padrão de qualidade.

CONHEÇA NOSSO
CATÁLOGO DE
PRODUTOS
SEM TOUCH
SCREEN
WWW.PHARMATEX.COM.BR



CENTRAL DE VENDAS

www.pharmatex.com.br
contato@pharmatex.com.br
41 3078-7760 • 41 3068-7012 • 41 3044-7606

PRODUTO COM A QUALIDADE

farmatex

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR

Pharmatex
Importer and Distributor of Medical Products

RESSUSCITADOR MANUAL INFANTIL

CONHEÇA A PHARMATEX
PRODUTOS INTERNACIONALMENTE
RECONHECIDOS
WWW.PHARMATEX.COM.BR



REGISTRO ANVISA: 80440960008

ORIGEM: IMPORTADA

MODELO: Infantil



Reanimação pulmonar de infantil

Advertências:

- Artigo médico hospitalar.
- Atóxico.
- Respeitar o prazo de validade;
- Se a embalagem estiver violada, não usar o produto;
- Deve ser armazenada em local ventilado.
- Descartar de acordo com as normas de biossegurança recomendadas.
- Antes de utilizar o RESSUSCITADOR MANUAL FARMATEX leia atentamente esta instrução para ter um aproveitamento ideal de suas funções e do modo de operação.
- Desmontar as peças e limpá-las separadamente antes de iniciar a esterilização.
- Sua higienização pode ser feita com água morna ou produtos neutros para evitar odor do composto utilizado. Fazer a limpeza com esponja plástica ou pano macio em todos os componentes. Nunca utilizar esponja de aço pois esta deixa resíduos de metal que podem levar a um desgaste prematuro das peças higienizadas.
- Para esterilização os componentes podem ser colocados em água fervente durante um tempo de 5 (cinco) minutos ou em autoclave (câmara quente) até 140°C durante o mesmo período.
- A assepsia é fundamental para que os contaminantes provenientes da manipulação ou de outros pacientes fiquem na peça, portanto esta operação é necessária para a segurança do profissional e do paciente.

Especificações

Volume do balão.....	1000 ml
Volume do reservatório de oxigênio.....	600 ml
Índice sistólico.....	< 700 ml (ASTM Standard Hand)
Espaço morto.....	10 ml
Resistência a exalação.....	< 4cm H2O @ 50 lpm fluxo
Alívio de pressão.....	40 cm H2O
Pressão de distribuição atingível.....	≥ 40 cm H2O
Frequência ventilatória.....	< 60 bpm (sem carga)
Temperatura de operação.....	-18°C a 51°C
Limites ambientais para estocagem.....	-40°C a 60°C
Reservatório de entrada do paciente.....	15mm / 22mm
Média de peso do dispositivo sem máscara.....	0,20 kg
Média de comprimento.....	25 cm
Limite de massa corporal para uso.....	< 40 kg
Quantidade por caixa.....	01

Volume Tidal	500 ml	500 ml	500 ml
Taxa	12 bpm	20 bpm	30 bpm
O2 taxa de fluxo	10 lpm	10 lpm	10 lpm
FDO2	99%	99%	99%

Modo de uso do produto

1. O paciente deve deitar-se com o rosto para cima.
2. Verificar se as vias aéreas estão desobstruídas.
3. Remover qualquer coisa que estiver na boca (dentadura por exemplo) e garganta do paciente.
4. Introduzir o tubo orofaríngeo na boca do paciente de modo a evitar que ele possa ferir a própria língua.
5. O operador deve posicionar-se atrás da cabeça do paciente, inclinando sua cabeça para trás e segurando de maneira firme para permitir dessa forma uma boa respiração, bem como puxar o seu queixo para cima.
6. Coloque a máscara cobrindo a boca e o nariz do paciente, fixando-a firmemente utilizando os dedos indicador e polegar.
7. Com a outra mão comprima o balão de forma ritmada aplicando uma pressão adequada de modo a facilitar a respiração do paciente.
8. O operador deve observar obrigatoriamente:
 - a) Se o tórax do paciente expande cada vez que o ar é insuflado e se comprime quando é expirado.
 - b) A cor do rosto e dos lábios do paciente.
 - c) O ressuscitador somente deve ser operado por pessoas bem treinadas e qualificadas.
9. Durante a ventilação verifique:
 - I. Sinais de cianose;
 - II. Adequação da ventilação;
 - III. Pressão das vias aéreas;
 - IV. Funcionamento correto de todas as válvulas;
 - V. Funcionamento correto do tubo de oxigênio e reservatório.

Precauções

- A. O RESSUSCITADOR MANUAL FARMATEX não deverá ser utilizado em ambientes tóxicos ou áreas perigosas que não possuem filtro de purificação para gases;
- B. Não remover a bolsa-reservatório se o oxigênio não estiver sendo fornecido, pois isto prejudicará ou obstruirá a respiração do paciente;
- C. Não aplicar qualquer tipo de óleo sobre o produto pois o mesmo poderá causar uma reação química e danificar os materiais de fabricação;
- D. Nunca tente utilizar objetos cortantes para remover qualquer tipo de sujeira do balão autoinflável, pois poderá furá-lo e consequentemente ocasionar a perda de sua função básica.

CENTRAL DE VENDAS

www.pharmatex.com.br
contato@pharmatex.com.br
41 3078-7760 • 41 3068-7012 • 41 3044-7606

PRODUTO COM A QUALIDADE

farmatex

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR

Pharmatex
Importer and Distributor of Medical Products

Item 02 e 03

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde



Detalhes do Produto

Nome da Empresa	ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA		
CNPJ	06.105.362/0001-23	Autorização	8.02.753-1
Produto	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE PREMIUM		

Modelo Produto Médico

BR-20D

H200 MESA/PAREDE

H200 RODIZIO

Nome Técnico	Esfigmomanometro
Registro	80275310022
Processo	25351.316086/2009-75
Origem do Produto	• FABRICANTE: WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

[Voltar](#)

Item 08

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde



Detalhes do Produto

Nome da Empresa	OLIDEF CZ IND COM APARELHOS HOSPITALARES LTDA		
CNPJ	55.983.274/0001-30	Autorização	1.02.271-8
Produto	Aspirador Cirurgico		

Modelo Produto Médico

A 45 - PLUS - (52047)

Nome Técnico	Aspirador Cirurgico
Registro	10227189012
Processo	25351.756509/2014-81
Origem do Produto	• FABRICANTE: OLIDEF CZ IND COM APARELHOS HOSPITALARES LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

[Voltar](#)

Lero 13

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde



Detalhes do Produto

Nome da Empresa	FORÇAMÉDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP		
CNPJ	02.477.745/0001-71	Autorização	8.11.309-9
Produto	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO		

Modelo Produto Médico

FM - 0010

Nome Técnico	Bracadeira Para Injecao
Registro	81130999001
Processo	25351.498137/2015-25
Origem do Produto	• FABRICANTE: FORÇAMÉDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

[Voltar](#)

13/09/18

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde



Detalhes do Produto

Nome da Empresa	ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA		
CNPJ	06.105.362/0001-23	Autorização	8.02.753-1
Produto	ESTETOSCÓPIO PREMIUM		

Modelo Produto Médico

ESTETOSCÓPIO PREMIUM SIMPLES - ADULTO; ESTETOSCÓPIO PREMIUM SIMPLES - PEDIÁTRICO; ESTETOSCÓPIO PREMIUM SIMPLES - ADULTO DELUXE; ESTETOSCÓPIO PREMIUM SIMPLES - PEDIÁTRICO DELUXE; ESTETOSCÓPIO PREMIUM DUPLO - ADULTO; ESTETOSCÓPIO PREMIUM DUPLO - PEDIÁTRICO; ESTETOSCÓPIO PREMIUM DUPLO - NEONATAL; ESTETOSCÓPIO PREMIUM CARDIOLÓGICO - ADULTO; ESTETOSCÓPIO PREMIUM CARDIOLÓGICO - PEDIÁTRICO; ESTETOSCÓPIO PREMIUM RAPPAPORT SIMPLES; ESTETOSCÓPIO PREMIUM RAPPAPORT; ESTETOSCÓPIO PREMIUM COLORIDO SIMPLES; ESTETOSCÓPIO PREMIUM COLORIDO DUPLO ; ESTETOSCÓPIO PREMIUM SIMPLES - DESCARTÁVEL; ESTETOSCÓPIO PREMIUM FLAT; ESTETOSCÓPIO PREMIUM SIMPLES - ADULTO- DE PLÁSTICO; ESTETOSCÓPIO PREMIUM SIMPLES - ADULTO - DE PLÁSTICO FLEXÍVEL; ESTETOSCÓPIO PREMIUM DUPLO - ADULTO DELUXE; ESTETOSCÓPIO PREMIUM DUPLO PEDIÁTRICO DELUXE; ESTETOSCÓPIO PREMIUM DUPLO NEONATAL DELUXE; ESTETOSCÓPIO PREMIUM DE TREINAMENTO.

Nome Técnico	Estetoscopio
Registro	80275310052
Processo	25351.167163/2012-64
Origem do Produto	• FABRICANTE: NINGBO SIFANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Item 24

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde



Detalhes do Produto

Nome da Empresa	MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE APARELHOS MEDICOS LTDA-EPP		
CNPJ	05.030.501/0001-34	Autorização	8.02.189-3
Produto	LANTERNA MULTICLINIC		

Modelo Produto Médico

Nenhum Modelo/Apresentação Encontrado(a)

Nome Técnico	Lanterna Clínica
Registro	80218939001
Processo	25351.201427/2005-97
Origem do Produto	• FABRICANTE: MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE APARELHOS MEDICOS LTDA-EPP - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

[Voltar](#)

Alfa Med

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde



Detalhes do Produto

Nome da Empresa	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA		
CNPJ	11.405.384/0001-49	Autorização	8.06.293-7
Produto	OXIMETRO DE PULSO SENSE		

Modelo Produto Médico

SENSE 10

Nome Técnico	Oxímetro de Pulso
Registro	80629370004
Processo	25351.562186/2012-16
Origem do Produto	• FABRICANTE: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	III - ALTO RISCO
Vencimento do Registro	29/04/2028



Voltar

Item 10

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde



Detalhes do Produto

Nome da Empresa	PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
CNPJ	07.946.202/0001-70	Autorização	8.04.409-6
Produto	RESSUSCITADOR MANUAL FARMATEX		

Modelo Produto Médico

Neonato - Pediátrico - Adulto Pequeno - Adulto

Nome Técnico	Ressuscitador Cardio-Pulmonar
Registro	80440960008
Processo	25351.512435/2011-03
Origem do Produto	• FABRICANTE: LAKHANI MEDICARE PVT.LTD - ÍNDIA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

[Voltar](#)